


RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

La invitația de participare nr. 27515 din data de 22.07.2024, privind achiziția de “Reparație etuve de laborator” au fost solicitate următoarele clarificări:

Întrebare 1: “Va rugam sa ne dati o poza cu eticheta din spate a etuvei LABOR MIM. Rezistenta pentru aceasta etuva o aveti Dvs.?”

Răspuns 1: “Pentru această etuvă nu avem rezistența pentru această etuva. Vă transmitem o poza cu eticheta din spate a etuvei LABOR MIM”

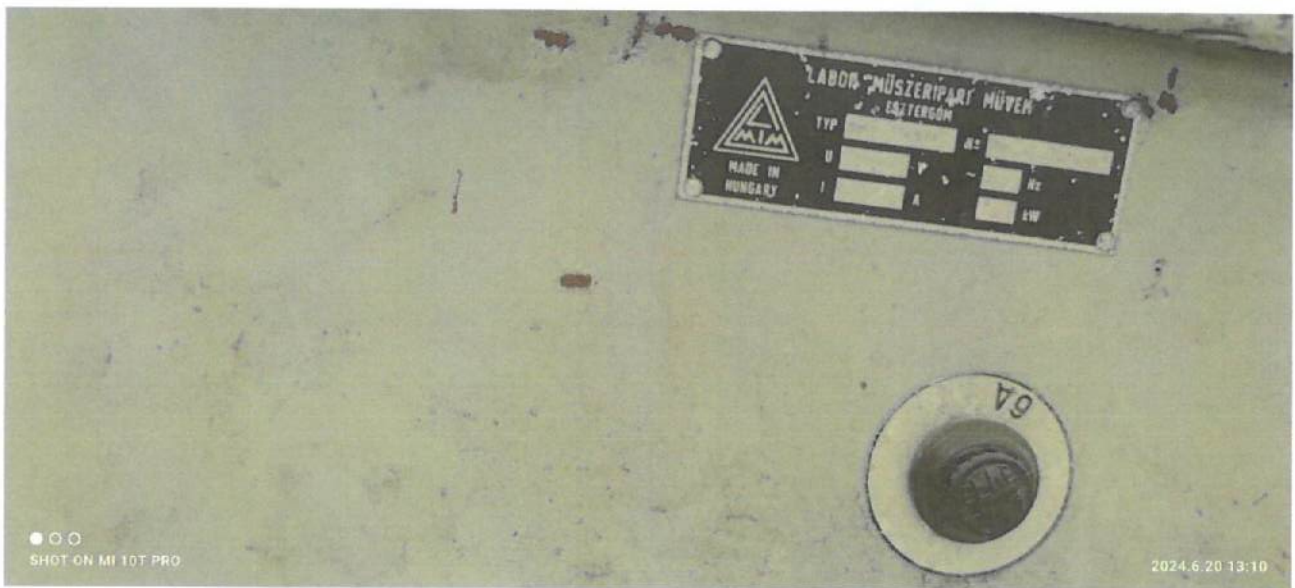

Cu considerație,

RECTOR

Prof. univ. dr. ing. habilit. Marian BARBU

Beneficiar:

Nechita Petronela

